


Инструкция по калибровке счетчика топлива Tech Flow 3C

Расходомер топлива TechFlow 3C предусматривает возможность калибровки.

Расходомер топлива поставляется откалиброванным для дизельного топлива с температурой 20°C. Калибровка счетчика топлива необходима при измерении других жидкостей, с другой вязкостью, при изменении температуры жидкости или после значительного износа. Для проведения калибровки счетчика необходима мерная ёмкость, желательно чтобы объём емкости был не менее 19 литров.

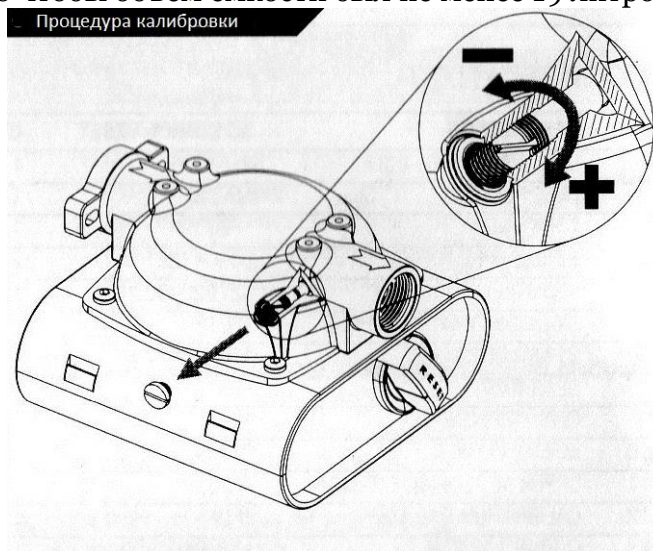

Процедура калибровки расходомера топлива Tech Flow 3C:

- 1.** Наполните мерную ёмкость жидкостью через расходомер топлива согласно технических характеристик по потоку (необходимо чтобы через счетчик топливо подавалось при скорости 20-120л./мин., учитывая начало потока и окончание потока).
- 2.** Если показания на расходомере топлива не совпадают с количеством в мерной ёмкости необходимо провести калибровку. Для этого удалите уплотнительный винт и поверните калибровочный винт; против часовой стрелки – чтобы уменьшить показания расходомера, или по часовой чтобы увеличить показания расходомера. Полный оборот винта приблизительно равен 2литрам жидкости. Установите на место уплотнительный винт.
- 3.** Повторите процедуру до тех пор пока показания расходомера топлива не будут совпадать с количеством в мерной емкости. После завершения рекомендуется опломбировать регулировочный винт, чтобы избежать несанкционированного доступа к нему.